


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1						
O	1	46.3	60.2	39.9	34	46.3	60.2	39.9	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
	2	47.8	52.7	34.9	34	45.8	58.4	36.2	32	-1.9	5.7	1.3	5.9	6.2	
	3	49.3	45.2	30.0	34	44.3	55.0	31.1	29	-5.0	9.8	1.1	9.9	11.1	
	4	50.8	37.6	25.0	34	43.6	50.4	23.8	25	-7.2	12.8	-1.1	12.8	14.7	
	5	52.3	30.1	20.0	34	44.6	43.7	18.6	23	-7.6	13.6	-1.3	13.7	15.7	
	6	53.8	22.6	15.0	34	46.1	32.9	13.8	23	-7.6	10.3	-1.1	10.4	13.0	
	7	55.3	15.1	10.0	34	49.6	19.9	9.5	26	-5.6	4.9	-0.4	4.9	7.5	
	8	56.8	7.5	5.1	34	55.4	7.8	2.8	20	-1.3	0.3	-2.2	2.3	2.7	
Z	9	58.4	0.0	0.1	90	58.4	0.0	0.1	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Orangerot – Cyanblau rgb: O – Z – C
	10	57.3	-1.7	-6.5	255	57.3	-8.2	-8.0	224	0.1	-6.4	-1.4	6.7	6.7	
	11	56.2	-3.4	-13.2	255	50.7	-15.3	-17.9	229	-5.4	-11.8	-4.6	12.8	13.9	
	12	55.1	-5.2	-19.9	255	47.3	-19.9	-26.5	233	-7.7	-14.6	-6.5	16.1	17.9	
	13	54.0	-7.0	-26.6	255	46.5	-22.0	-35.0	238	-7.4	-15.0	-8.3	17.2	18.8	
	14	52.9	-8.7	-33.3	255	48.0	-23.4	-40.1	240	-4.8	-14.6	-6.7	16.2	16.9	
	15	51.8	-10.5	-40.0	255	47.4	-20.5	-43.4	245	-4.4	-9.9	-3.3	10.6	11.5	
	16	50.7	-12.2	-46.7	255	47.9	-20.1	-45.0	246	-2.7	-7.8	1.7	8.0	8.5	
C	17	49.6	-14.0	-53.4	255	49.6	-14.0	-53.4	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta H^*_{CIELAB} = 8.7$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 9.7$
	18	46.3	60.2	39.9	34	46.3	60.2	39.9	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
O	19	52.3	30.1	20.0	34	44.6	43.7	18.6	23	-7.6	13.6	-1.3	13.7	15.7	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	20	58.4	0.0	0.1	90	58.4	0.0	0.1	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Z	21	54.0	-7.0	-26.6	255	46.5	-22.0	-35.0	238	-7.4	-15.0	-8.3	17.2	18.8	$\Delta H^*_{CIELAB} = 6.2$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 6.9$
	22	49.6	-14.0	-53.4	255	49.6	-14.0	-53.4	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	


YG310–3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1						
O	1	48.3	58.2	45.6	38	48.3	58.2	45.6	38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
	2	48.9	50.7	40.7	39	48.7	51.8	40.6	38	-0.1	1.1	0.0	1.1	1.1	
	3	49.5	43.2	35.9	40	49.3	47.3	35.8	37	-0.2	4.1	0.0	4.1	4.1	
	4	50.2	35.7	31.0	41	50.4	41.2	30.6	37	0.3	5.5	-0.3	5.5	5.5	
	5	50.8	28.2	26.2	43	51.3	33.0	26.5	39	0.5	4.8	0.4	4.8	4.8	
	6	51.5	20.7	21.3	46	51.5	24.3	21.1	41	0.1	3.6	-0.1	3.6	3.6	
	7	52.1	13.2	16.4	51	52.4	14.4	17.2	50	0.3	1.2	0.8	1.4	1.5	
	8	52.7	5.7	11.6	64	53.3	5.4	11.7	65	0.6	-0.2	0.1	0.3	0.7	
Z	9	53.4	-1.7	6.7	105	53.4	-1.7	6.7	105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Orangerot – Cyanblau cmy0: O – Z – C
	10	53.6	-4.0	0.8	169	53.5	-8.1	0.8	174	0.0	-4.0	0.0	4.1	4.1	
	11	53.9	-6.3	-5.0	218	53.5	-13.0	-3.3	195	-0.3	-6.6	1.7	6.9	6.9	
	12	54.1	-8.6	-10.9	232	53.8	-16.8	-9.0	208	-0.3	-8.1	1.9	8.4	8.4	
	13	54.4	-11.0	-16.8	237	52.9	-20.0	-14.8	217	-1.4	-9.0	2.0	9.3	9.4	
	14	54.6	-13.3	-22.7	240	53.9	-21.8	-20.3	223	-0.6	-8.4	2.4	8.9	8.9	
	15	54.9	-15.6	-28.6	241	53.9	-21.3	-26.5	231	-0.9	-5.6	2.1	6.1	6.2	
	16	55.1	-17.9	-34.5	243	54.5	-21.3	-33.2	237	-0.5	-3.3	1.3	3.7	3.7	
C	17	55.4	-20.2	-40.4	243	55.4	-20.2	-40.4	243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen) $\Delta H^*_{CIELAB} = 4.0$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 4.1$
	18	48.3	58.2	45.6	38	48.3	58.2	45.6	38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
O	19	50.8	28.2	26.2	43	51.3	33.0	26.5	39	0.5	4.8	0.4	4.8	4.8	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen) $\Delta H^*_{CIELAB} = 2.8$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 2.8$
	20	53.4	-1.7	6.7	105	53.4	-1.7	6.7	105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Z	21	54.4	-11.0	-16.8	237	52.9	-20.0	-14.8	217	-1.4	-9.0	2.0	9.3	9.4	
	22	55.4	-20.2	-40.4	243	55.4	-20.2	-40.4	243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

YG311–3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

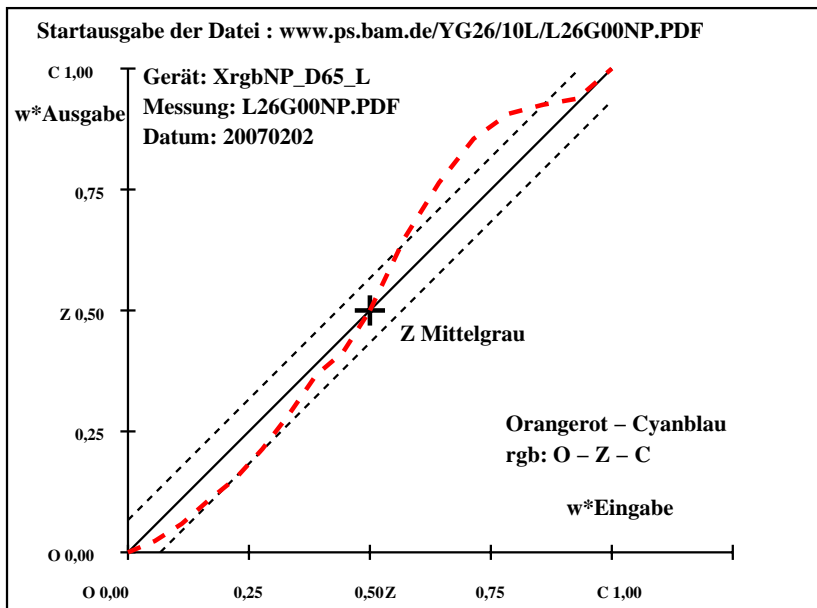

YG310–7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

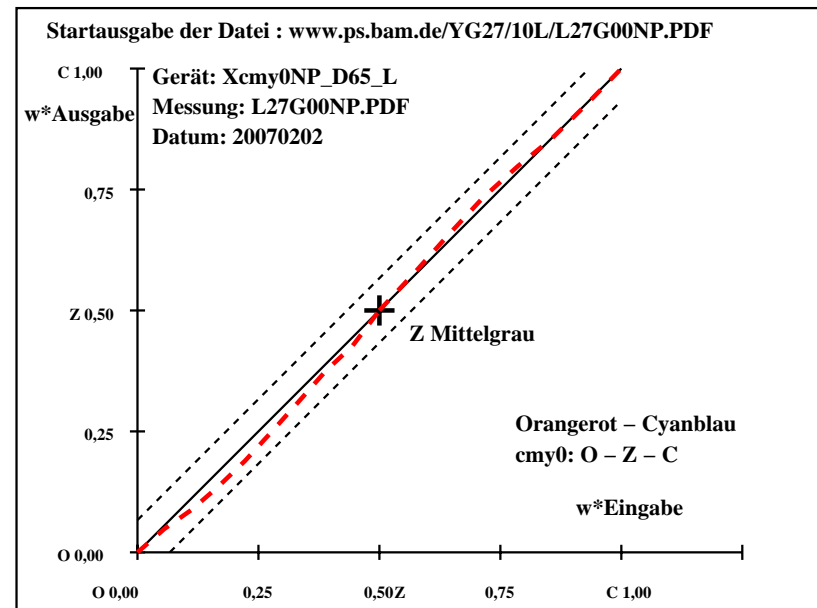

YG311–7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202