


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1							
Y	1	91.5	-10.1	109.3	95	91.5	-10.1	109.3	95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G</b>
	2	86.8	-8.7	96.5	95	83.6	-8.3	91.3	95	-3.1	0.4	-5.1	5.2	6.1	
	3	82.1	-7.3	83.7	95	80.1	-8.2	81.8	96	-1.9	-0.8	-1.8	2.1	2.9	
	4	77.3	-5.9	70.9	95	75.6	-6.3	66.3	96	-1.7	-0.3	-4.5	4.6	4.9	
	5	72.6	-4.6	58.1	95	70.9	-4.4	50.6	95	-1.6	0.2	-7.4	7.5	7.7	
	6	67.8	-3.2	45.2	94	66.0	-2.8	36.1	95	-1.7	0.4	-9.0	9.1	9.3	
	7	63.1	-1.8	32.4	93	62.0	-1.0	25.3	92	-1.0	0.8	-7.0	7.2	7.3	
	8	58.4	-0.4	19.6	91	57.9	0.0	14.7	90	-0.4	0.5	-4.8	4.9	5.0	
Z	9	53.6	0.9	6.8	82	53.6	0.9	6.8	82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>Gelb – Violettblau rgb: Y – Z – V</b>
	10	50.2	2.4	1.5	32	49.0	2.3	-0.8	339	-1.1	0.0	-2.3	2.4	2.6	
	11	46.7	3.8	-3.8	315	45.1	5.4	-9.4	300	-1.6	1.6	-5.5	5.8	6.1	
	12	43.3	5.3	-9.1	300	40.7	6.4	-17.9	290	-2.5	1.1	-8.7	8.9	9.2	
	13	39.8	6.8	-14.5	295	36.8	8.5	-23.1	290	-2.9	1.7	-8.6	8.8	9.3	
	14	36.3	8.2	-19.8	292	33.3	9.0	-27.8	288	-2.9	0.8	-7.9	8.1	8.6	
	15	32.9	9.7	-25.1	291	31.2	10.5	-30.5	289	-1.6	0.8	-5.3	5.4	5.7	
	16	29.4	11.1	-30.5	290	28.1	11.8	-33.2	290	-1.2	0.7	-2.6	2.8	3.1	
V	17	26.0	12.6	-35.8	289	26.0	12.6	-35.8	289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)</b> $\Delta H^*_{CIELAB} = 4.9$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 5.2$
Y	18	91.5	-10.1	109.3	95	91.5	-10.1	109.3	95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	72.6	-4.6	58.1	95	70.9	-4.4	50.6	95	-1.6	0.2	-7.4	7.5	7.7	<b>Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)</b> $\Delta H^*_{CIELAB} = 3.3$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 3.4$
Z	20	53.6	0.9	6.8	82	53.6	0.9	6.8	82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	21	39.8	6.8	-14.5	295	36.8	8.5	-23.1	290	-2.9	1.7	-8.6	8.8	9.3	
V	22	26.0	12.6	-35.8	289	26.0	12.6	-35.8	289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	


YG320-3N, Gerät: XcmyNP\_D50\_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1						
Y	1	90.9	-17.3	110.7	99	90.9	-17.3	110.7	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G</b>
	2	86.3	-15.2	97.7	99	83.1	-15.0	92.3	99	-3.1	0.2	-5.3	5.4	6.3	
	3	81.6	-13.1	84.7	99	79.6	-14.6	82.6	100	-1.9	-1.4	-2.0	2.6	3.3	
	4	77.0	-11.0	71.7	99	75.2	-12.1	66.7	100	-1.7	-1.0	-4.9	5.2	5.5	
	5	72.3	-8.9	58.8	99	70.5	-9.4	50.7	101	-1.7	-0.5	-7.9	8.1	8.3	
	6	67.6	-6.7	45.8	98	65.8	-6.8	36.1	101	-1.7	0.0	-9.6	9.7	9.8	
	7	63.0	-4.6	32.8	98	61.8	-4.2	25.2	100	-1.0	0.4	-7.5	7.6	7.7	
	8	58.3	-2.5	19.8	98	57.8	-2.1	14.7	99	-0.4	0.4	-5.0	5.1	5.1	
Z	9	53.7	-0.4	6.8	94	53.7	-0.4	6.8	94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>Gleichmäßigkeit g* = 51.7</b>
	10	50.3	1.9	1.5	38	49.1	1.8	-0.8	333	-1.0	0.0	-2.3	2.4	2.7	
	11	46.9	4.4	-3.7	319	45.3	6.0	-9.4	302	-1.6	1.6	-5.6	6.0	6.2	
	12	43.5	6.8	-9.0	307	41.0	8.4	-17.8	295	-2.4	1.6	-8.7	9.0	9.3	
	13	40.1	9.3	-14.3	303	37.2	11.5	-22.9	297	-2.9	2.3	-8.6	8.9	9.4	
	14	36.8	11.7	-19.5	301	33.8	13.1	-27.4	295	-2.9	1.4	-7.8	8.0	8.5	
	15	33.4	14.1	-24.8	300	31.7	15.3	-30.2	297	-1.6	1.2	-5.3	5.5	5.8	
	16	30.0	16.6	-30.1	299	28.7	17.4	-32.9	298	-1.2	0.8	-2.7	2.9	3.2	
V	17	26.6	19.0	-35.4	298	26.6	19.0	-35.4	298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>Gelb – Violettblau cmy0: Y – Z – V</b>
Y	18	90.9	-17.3	110.7	99	90.9	-17.3	110.7	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	72.3	-8.9	58.8	99	70.5	-9.4	50.7	101	-1.7	-0.5	-7.9	8.1	8.3	
Z	20	53.7	-0.4	6.8	94	53.7	-0.4	6.8	94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	21	40.1	9.3	-14.3	303	37.2	11.5	-22.9	297	-2.9	2.3	-8.6	8.9	9.4	
	22	26.6	19.0	-35.4	298	26.6	19.0	-35.4	298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	23	26.6	19.0	-35.4	298	26.6	19.0	-35.4	298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	24	26.6	19.0	-35.4	298	26.6	19.0	-35.4	298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

YG321-3N, Gerät: Xcmy0NP\_D65\_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

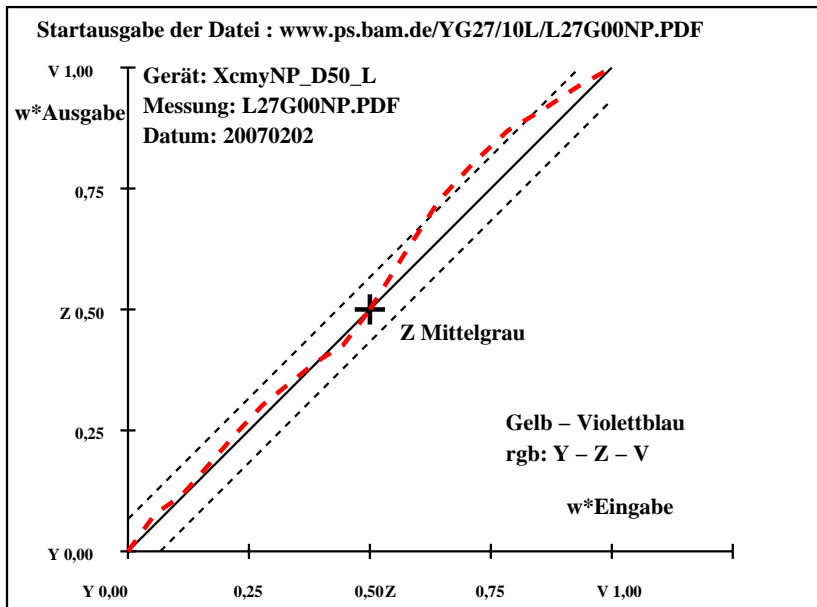

YG320-7N, Gerät: XcmyNP\_D50\_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

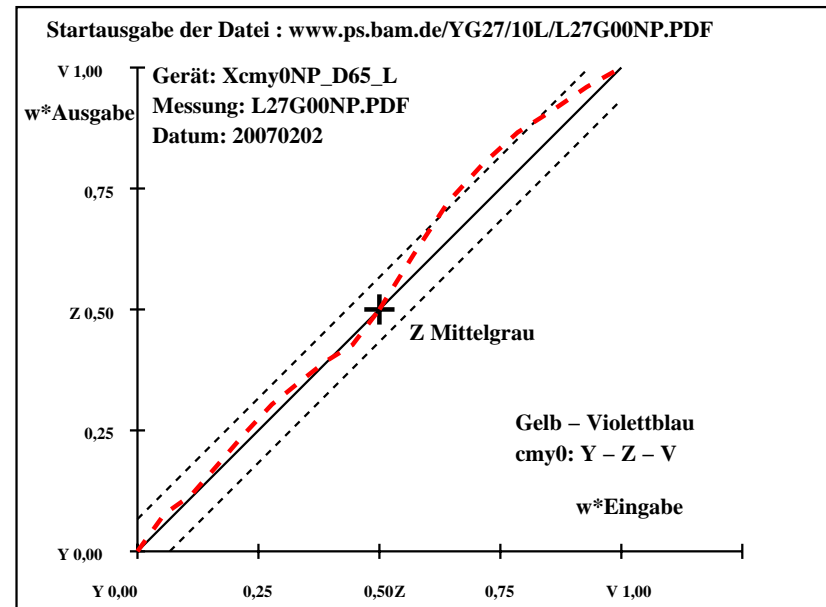

YG321-7N, Gerät: Xcmy0NP\_D65\_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202