


Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg21/10L/L21g00NP.PDF


Gerät: XcmyNP_D50_L

Messung: L21g00NP.PDF


Datum: 20070202

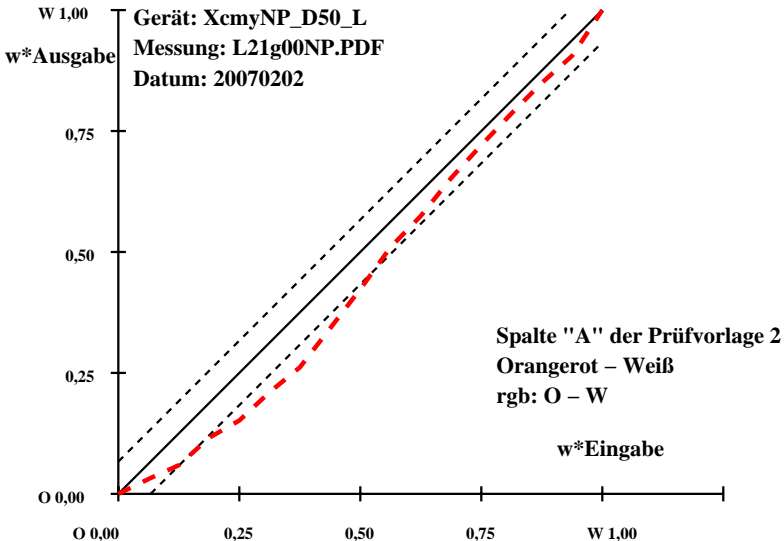


Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg21/10L/L21g00NP.PDF

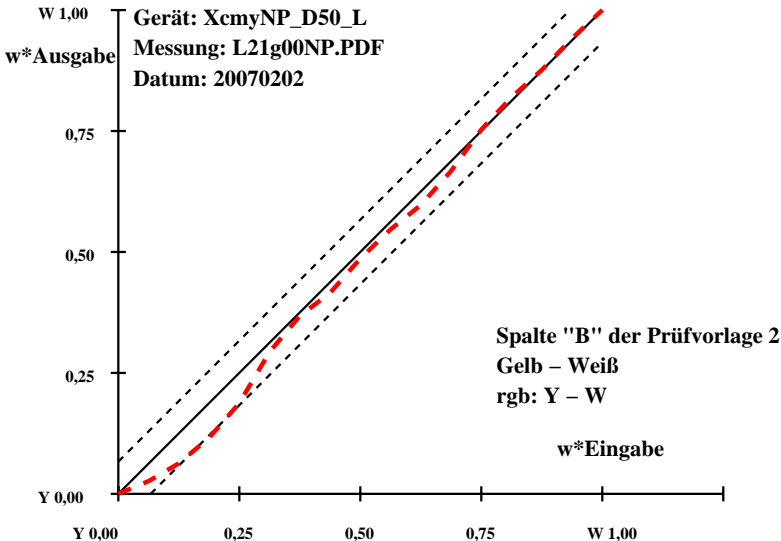


Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg21/10L/L21g00NP.PDF

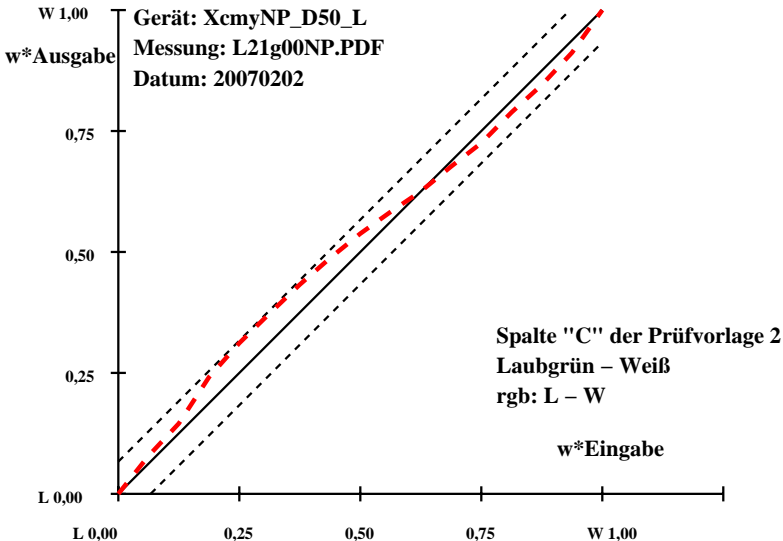


Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg21/10L/L21g00NP.PDF

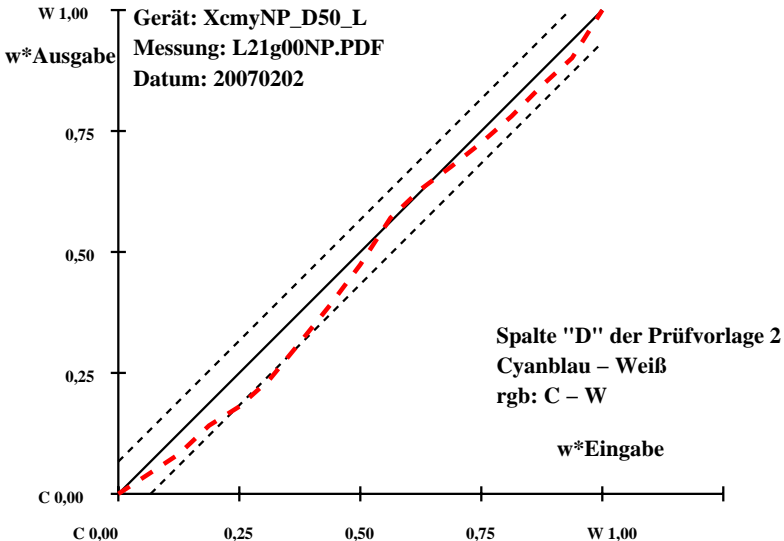


Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg21/10L/L21g00NP.PDF

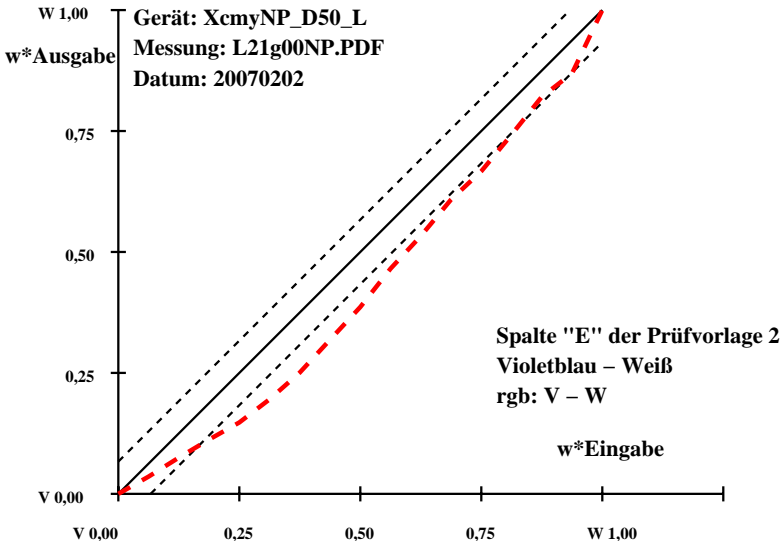


Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg21/10L/L21g00NP.PDF

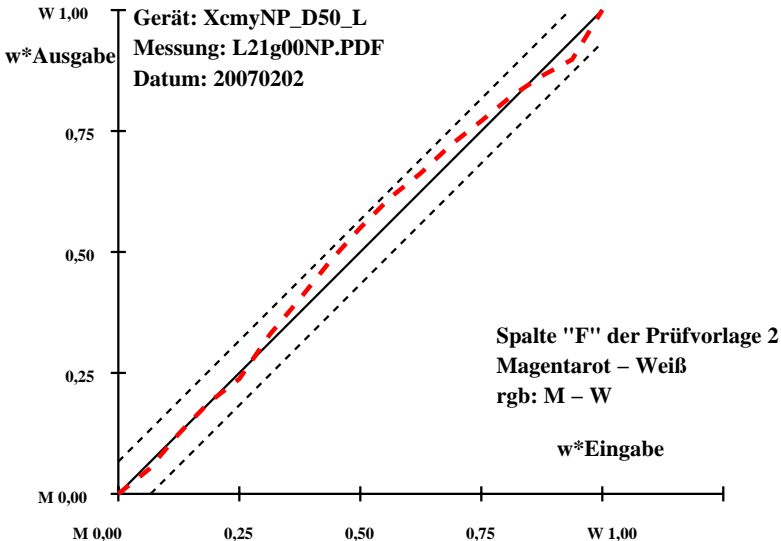


Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg21/10L/L21g00NP.PDF

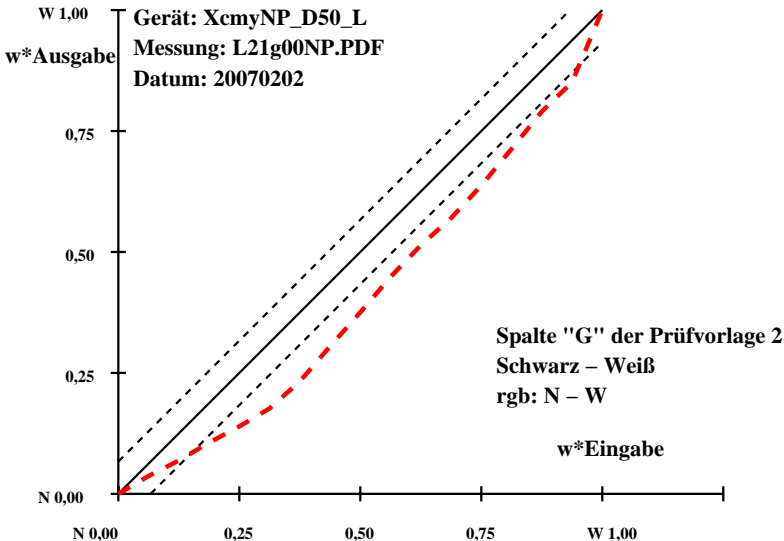


Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg21/10L/L21g00NP.PDF

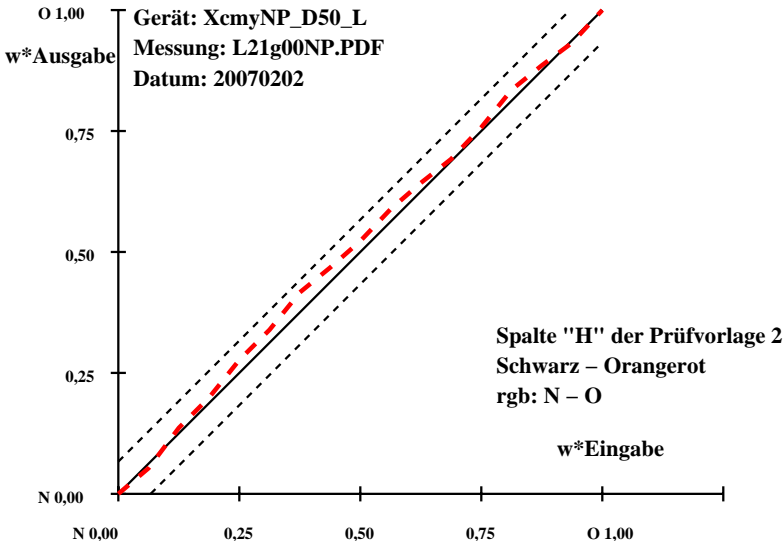


Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg21/10L/L21g00NP.PDF

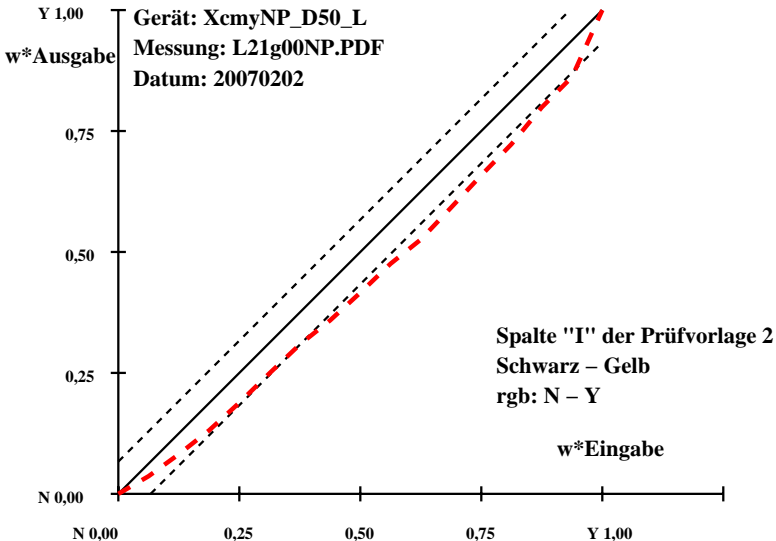


Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg21/10L/L21g00NP.PDF

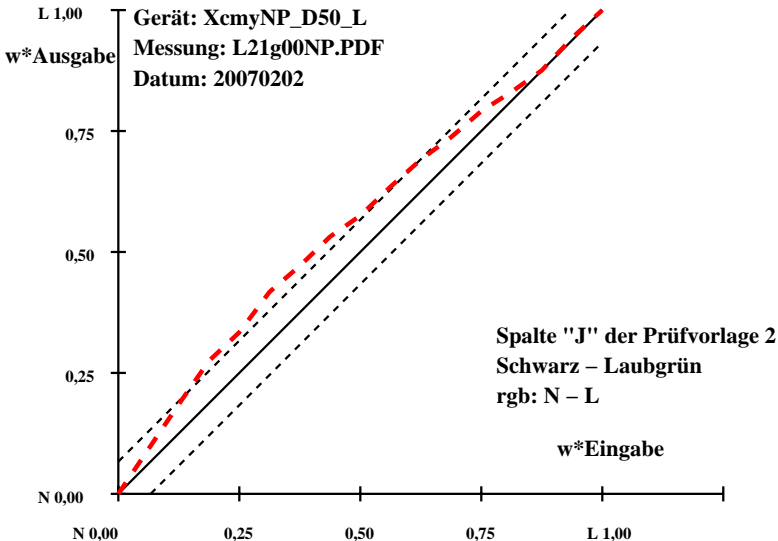


Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg21/10L/L21g00NP.PDF

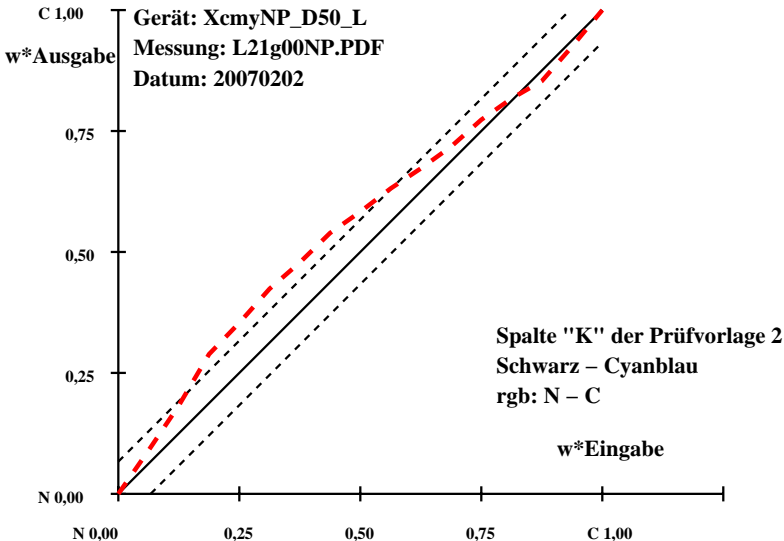


Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg21/10L/L21g00NP.PDF

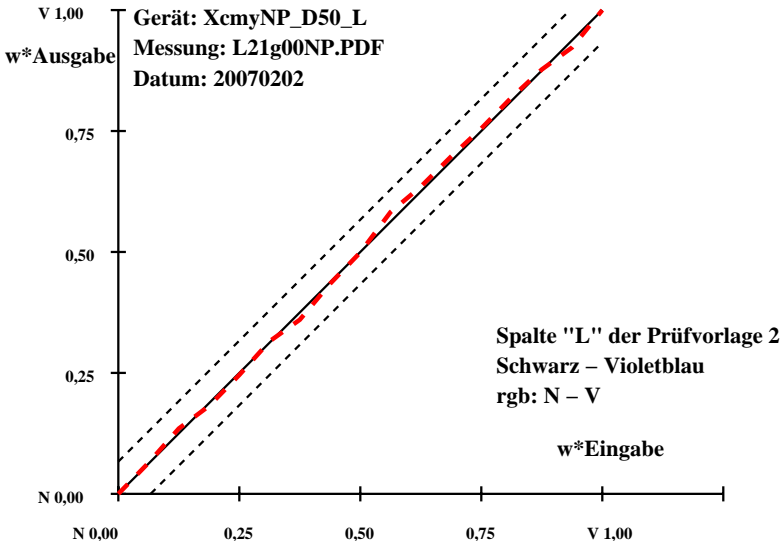


Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg21/10L/L21g00NP.PDF

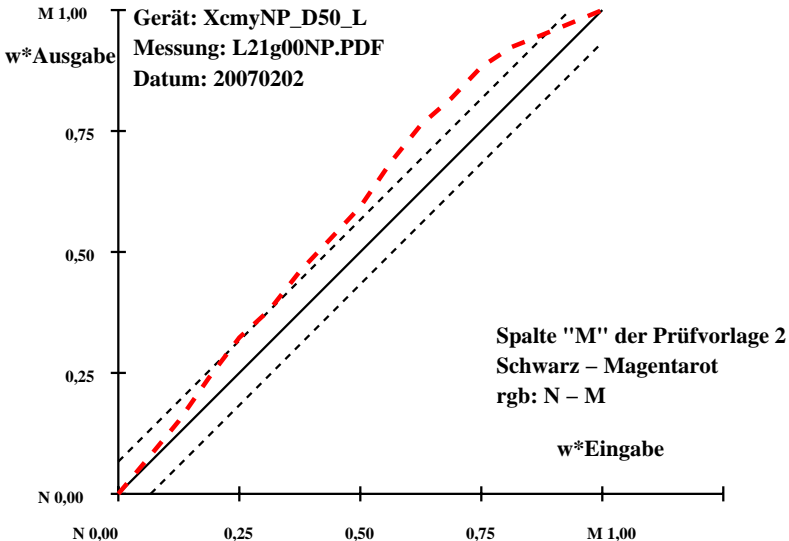


Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg21/10L/L21g00NP.PDF

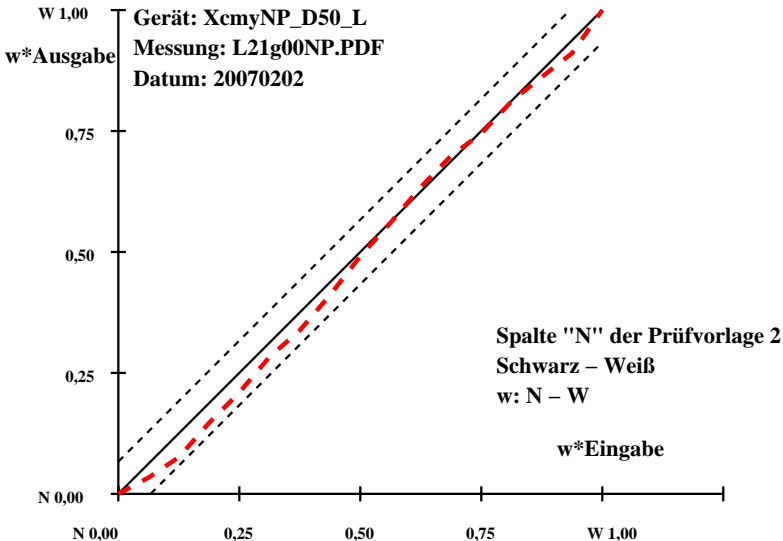


Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg21/10L/L21g00NP.PDF

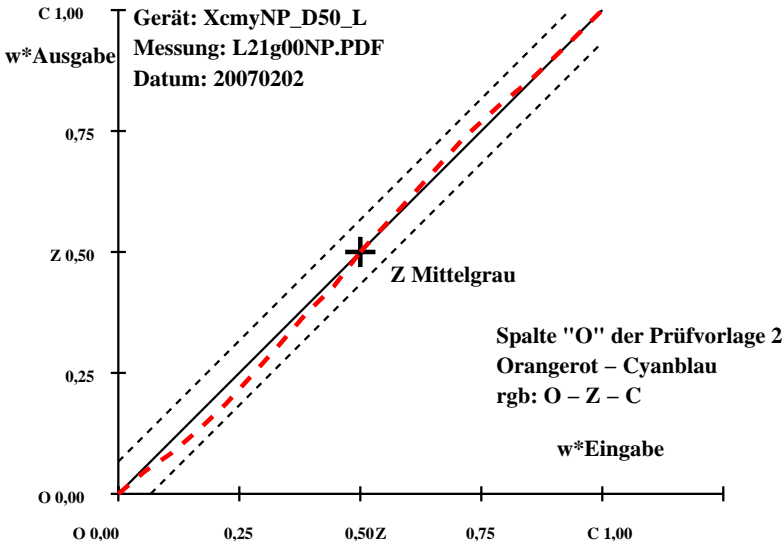


Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg21/10L/L21g00NP.PDF

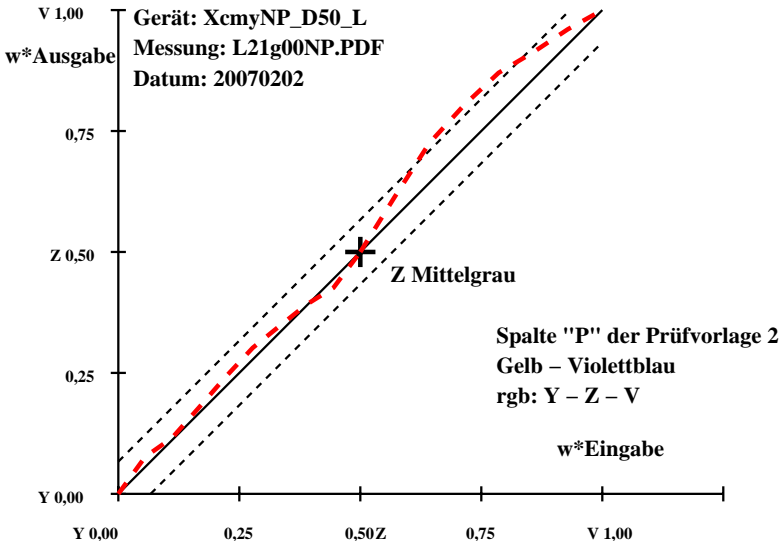


Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg21/10L/L21g00NP.PDF

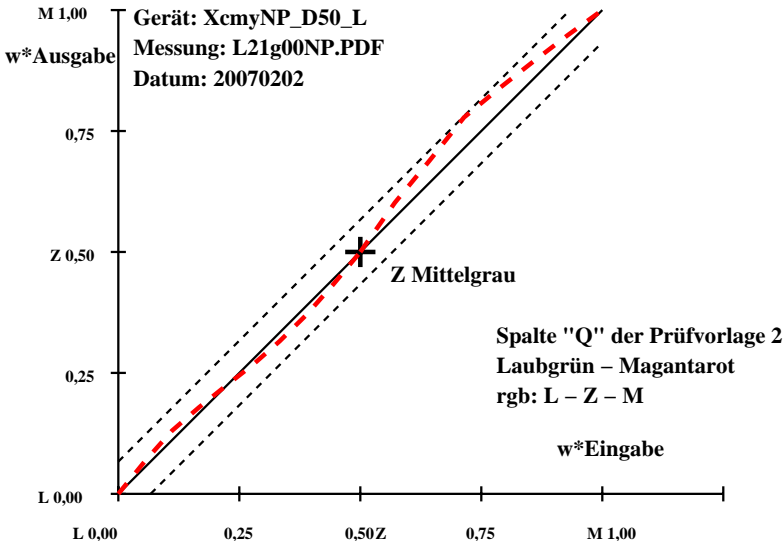

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg21/10L/L21g00NP.PDF

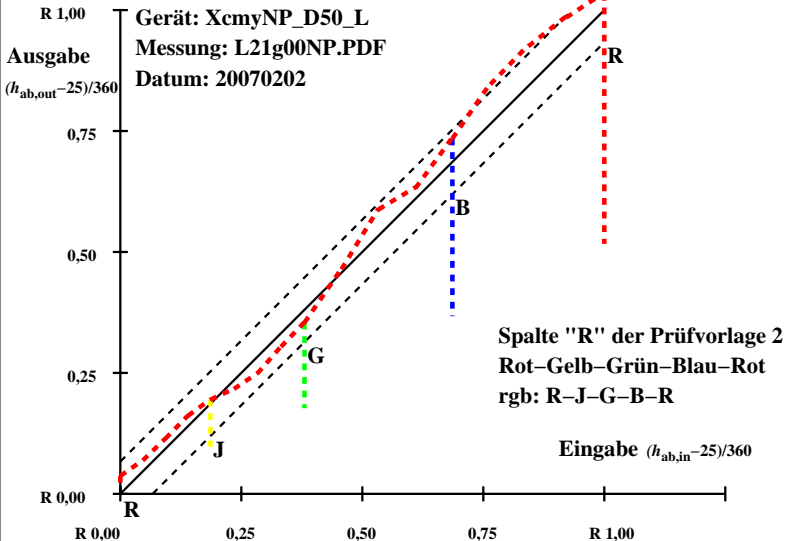

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg21/10L/L21g00NP.PDF

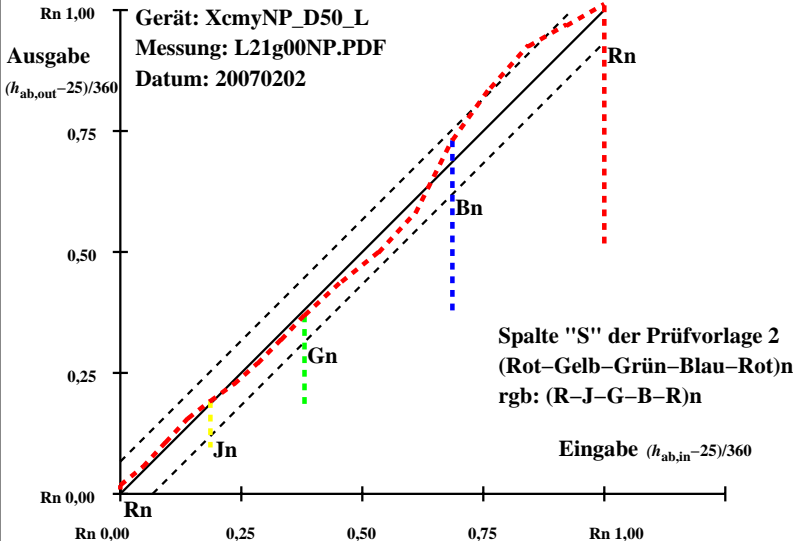

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg21/10L/L21g00NP.PDF

Gerät: XcmyNP_D50_L

Messung: L21g00NP.PDF

Datum: 20070202

Ausgabe

$(h_{ab,out}-25)/360$

Rw 1,00

0,75

0,50

0,25

Rw 0,00

Rw

Rw 0,00

0,25

0,50

0,75

Rw 1,00

Bw

Gw


Jw

Rw


Spalte "T" der Prüfvorlage 2
(Rot-Gelb-Grün-Blau-Rot)w
rgb: (R-J-G-B-R)w

Eingabe $(h_{ab,in}-25)/360$


Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg21/10L/L21g00NP.PDF

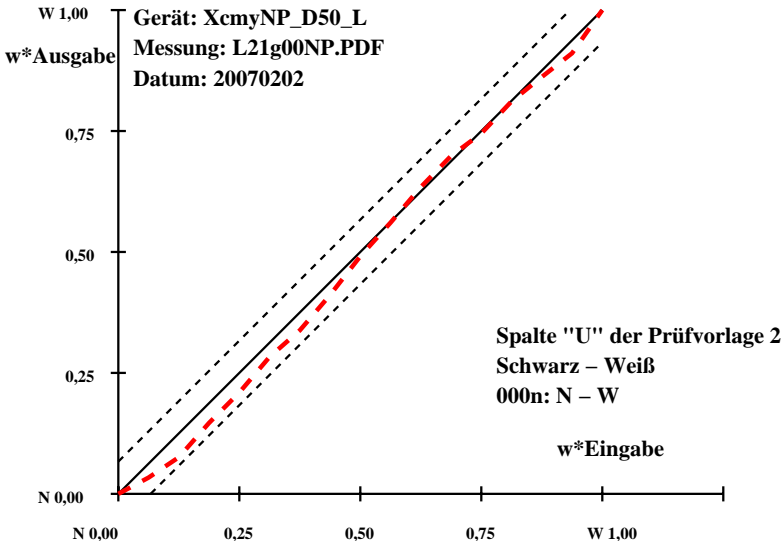

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg21/10L/L21g00NP.PDF

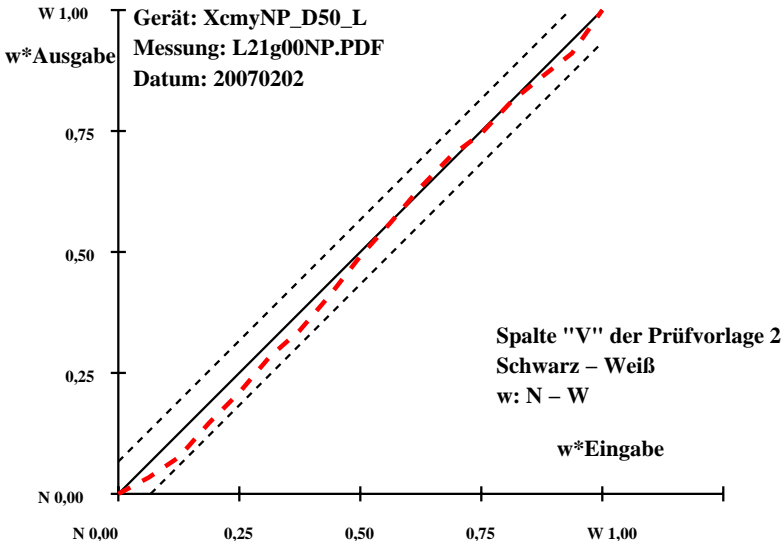

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg21/10L/L21g00NP.PDF

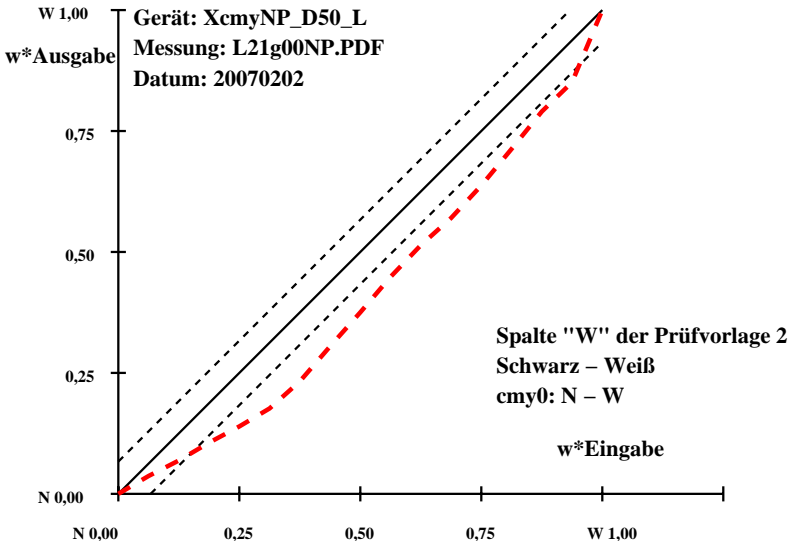

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/Dg21/10L/L21g00NP.PDF

Gerät: XcmyNP_D50_L

Messung: L21g00NP.PDF

Datum: 20070202

