


voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF89/TF89L0NP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TF890-3, Fig. D1W-: motif fleuri, 14 CIE test couleurs et 2 + 16 paliers de gris (sf); PS opérateur: 4 colorimage

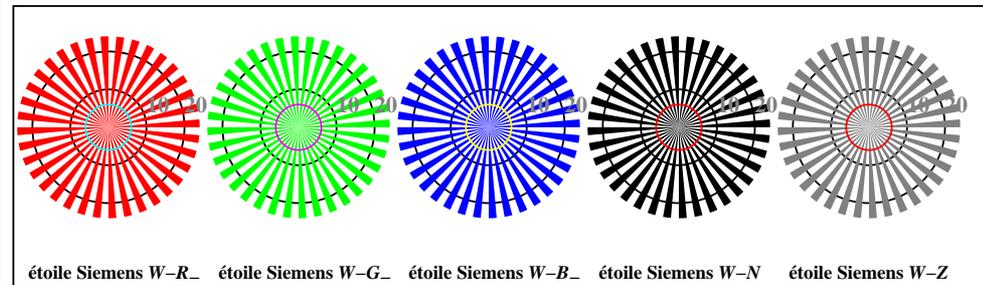


étoile Siemens W-R_ étoile Siemens W-G_ étoile Siemens W-B_ étoile Siemens W-N étoile Siemens W-Z

TF890-5, Fig. D2W-: étoile de Siemens W-R_; W-G_; W-B_; W-N; PS opérateur : rgb setrgbcolor

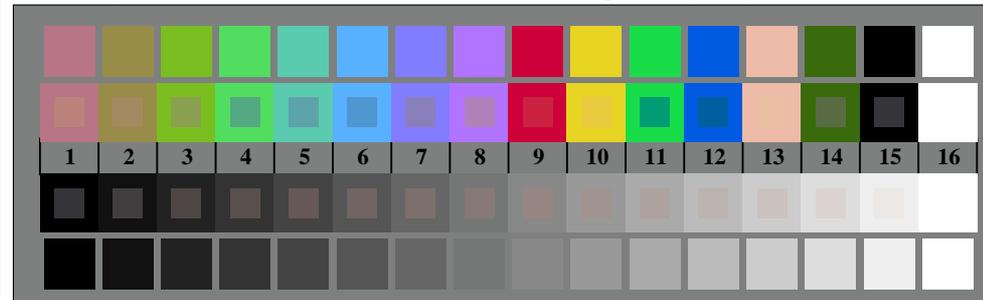


TF890-7, Fig. D3W-: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 paliers de gris (sf); PS opérateur: rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color


graphique TF89; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) entrée: rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
chromatic graphique de test RGB sortie: aucun changement

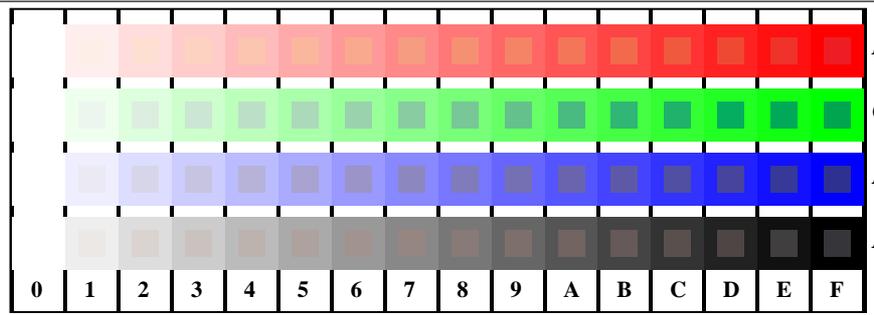


TF891-1, Fig. D4W-: 16 paliers équidistants W-R_; W-G_; W-B_; W-N; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color

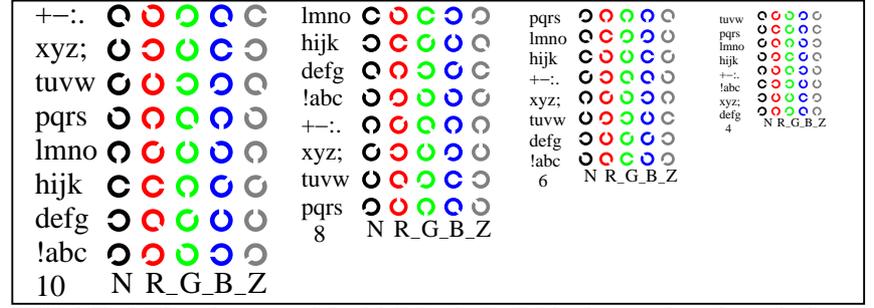

TF891-3, Fig. D5W-: code et anneau de Landolt N; R.; G.; B.; Z; PS opérateur: rgb->rgb_setrgbcolor

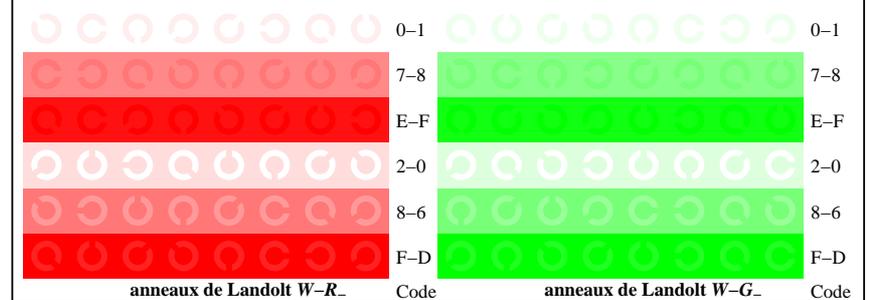

TF891-5, Fig. D6W-: anneaux de Landolt W-R_; W-G_; PS opérateur: rgb setrgbcolor

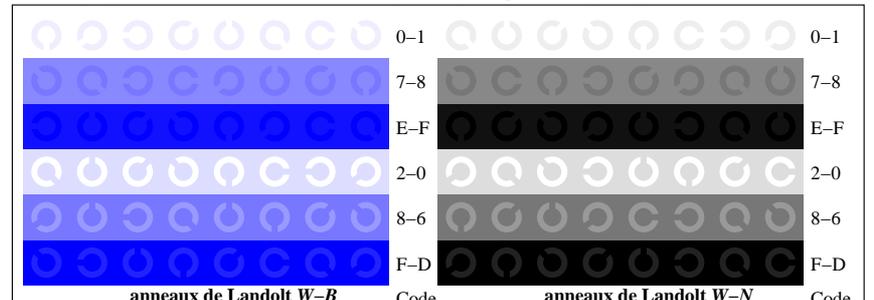

TF891-7, Fig. D7W-: anneaux de Landolt W-B_; W-N; PS opérateur: rgb setrgbcolor

TUB enregistrement: 20150701 - TF89/TF89L0NP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser

TUB matériel: code=rh4ta