
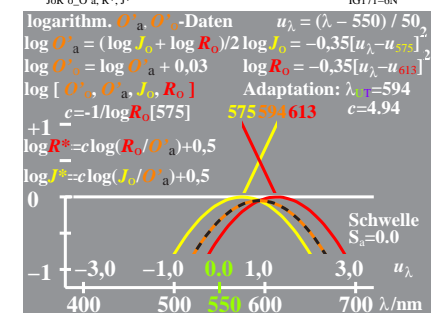
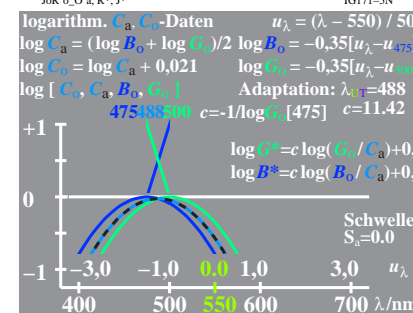
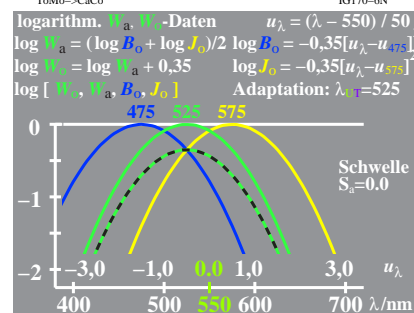
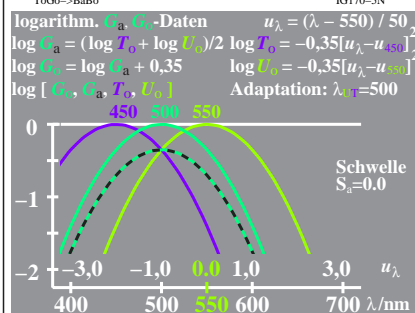
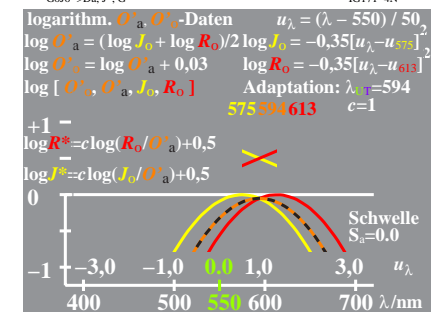
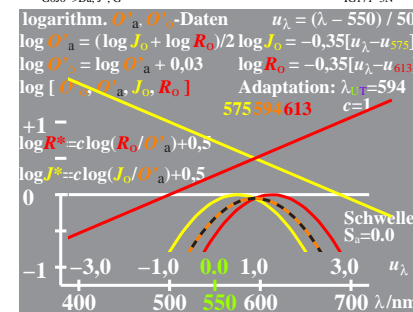
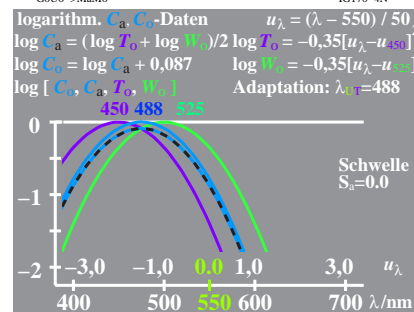
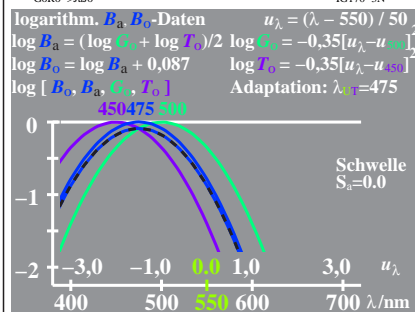
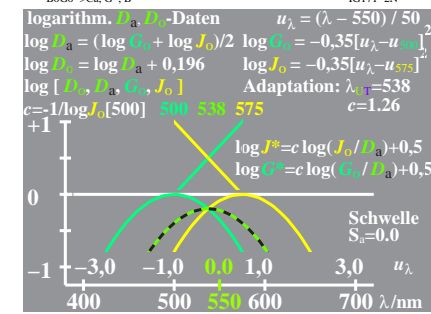
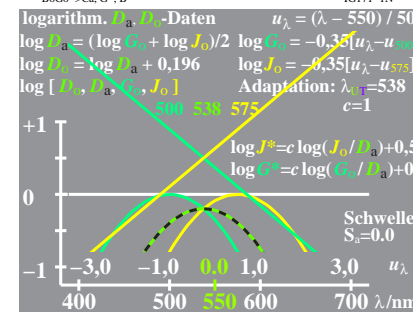
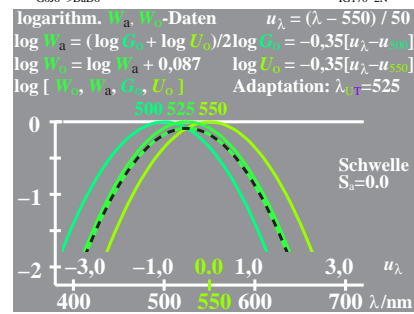
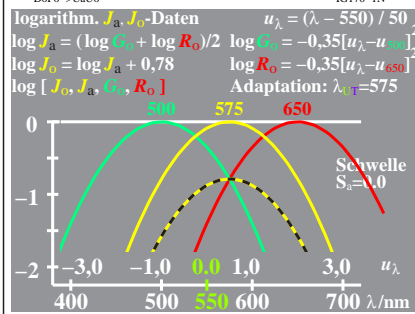
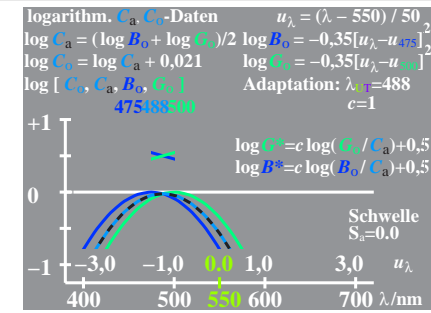
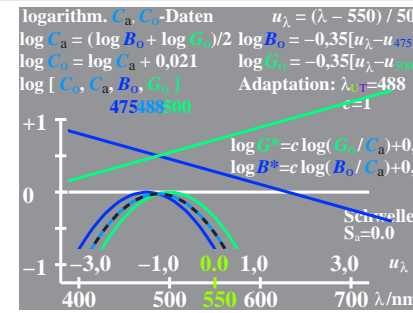
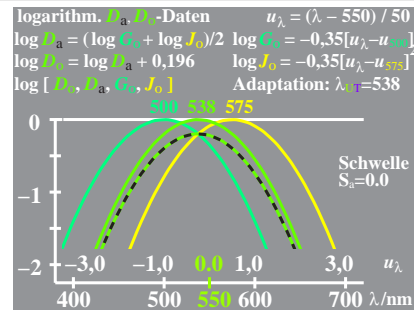


Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus-richter/IG17/IG17L0NP.PDF> /.PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

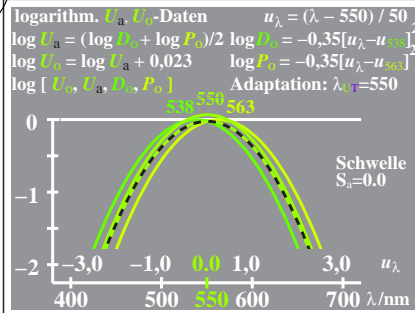

IG170-7X, 1

TUB-Registrierung: 20090701-IG17/IG17L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rhaxta