


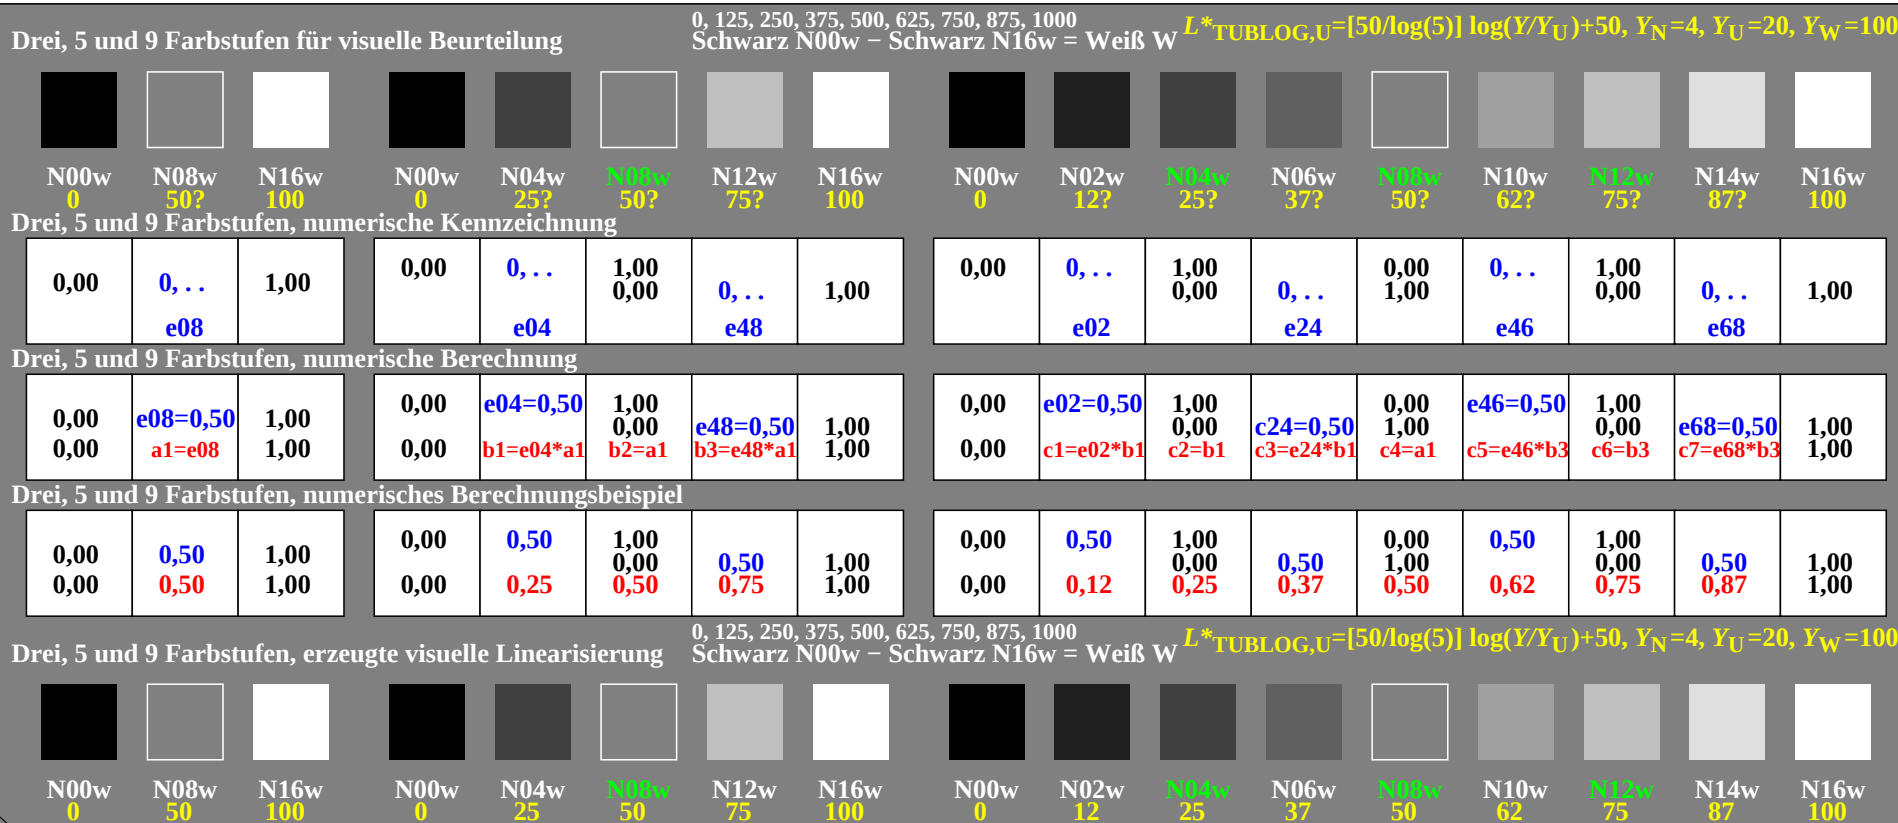

hga40-7n, Prüfmuster: 3, 5 und 9 Farbstufen, greu=0,500, expu=1,000, expa=1,000, expi=1,000

TUB-Prüfvorlage hga4; Separate Graumuster visuelle Intervallskalierung, Beurteilung
Serie N-W mit 3, 5 und 9 Stufen, Ausgabe $(rgb^*)^{1,0}$ & $[(rgb^*)^{1,0}]^{1,0}$; Umfeld Mittelgrau U=N08w