


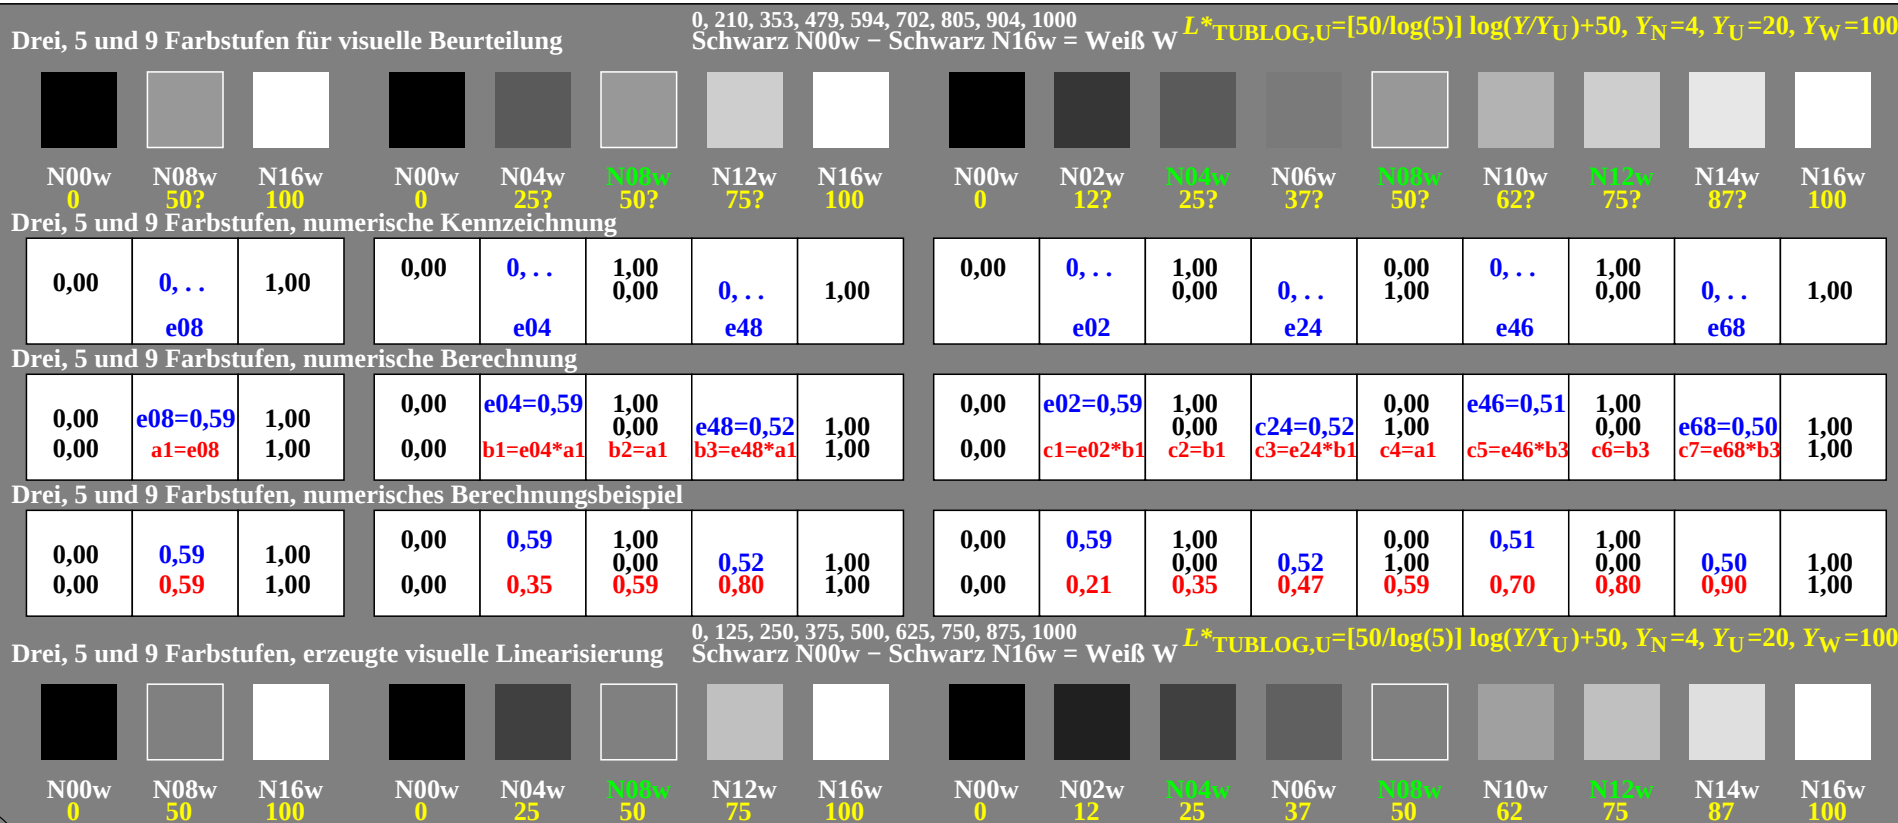

hga60-7n, Prüfmuster: 3, 5 und 9 Farbstufen, greu=0,500, expu=1,000, expa=0,750, expi=1,330

TUB-Prüfvorlage hga6; Separate Graumuster visuelle Intervallskalierung, Beurteilung
Serie N-W mit 3, 5 und 9 Stufen, Ausgabe $(rgb^*)^{0,75}$ & $[(rgb^*)^{0,75}]^{1,33}$; Umfeld Mittelgrau U=N08w